



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Secretaria Municipal de Saúde

Tel.: 14 3602-3777 - ramal 3710

59

## ANEXO I-A

ITEM	EQUIPAMENTO
<p>Equipamento de Ultrassom Diagnóstico transportável sobre rodízios com foco em Radiologia, Ginecologia e Obstetrícia.</p> <p>Aplicações em: ginecologia, obstetrícia, ecografia abdominal geral, urologia, cerebrovascular, vascular periférico, ecografia mamária, cardiologia, musculoesquelético, pequenas partes (tireoide, testículo), transcraniano e transfontanela.</p>	<p>Sistema digital de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e tecidual, possibilidade de Software 4D em tempo real. Modo 2D. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído speckle, zoom Read/Write de no mínimo 8X. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M. Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculo específico. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral. Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Permitir acesso as imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pósprocessamento de medidas. Pós processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame - rate extremamente elevado. Software de imagem estendida ou panorâmica de 50 cm ou maior. Software de leitura automática para cálculo da biometria fetal. Software de leitura automática ou semiautomática para cálculo da média íntima das carótidas. Possibilidade de upgrade para realizar exames de cardiologia com software para análise de strain cardíaco pela tecnologia speckle</p>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU

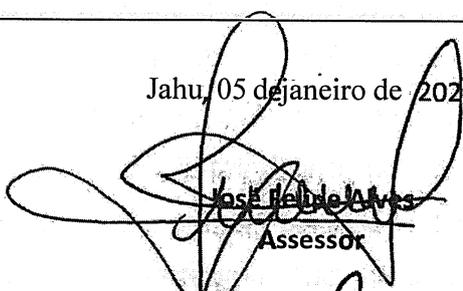
"Fundada em 15 de agosto de 1853"

Secretaria Municipal de Saúde

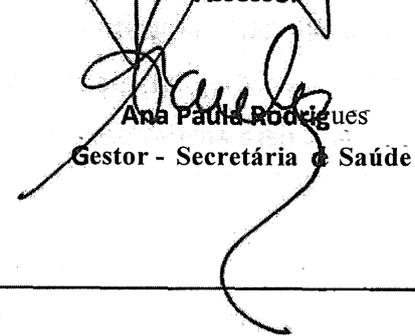
Tel.: 14 3602-3777 - ramal 3710

tracking e software de leitura automática para cálculo da fração de ejeção cardíaca. Todos os transdutores multifrequênciais, banda larga DVD-RW integrado. DICOM 3.0 completos (Print, Storage, MWM MPPS). HD interno de no mínimo 160GB. 04 portas USB no mínimo Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo com frequências de 2.0 a 6.0 MHz, permitido variação de +/- 1 Mhz Transdutor Linear com frequências de 5 a 13 MHz, permitido variação de +/- 1 Mhz; Transdutor Endocavitário com frequência de 4.0 a 9.0 MHz permitido variação de +/- 1 Mhz e guia de biópsia. Acessórios Impressora Laser Colorida e no brea1 compatível com o equipamento Tensão de acordo com a entidade solicitante. Na proposta o valor do equipamento deve contemplar todos os custos com impostos, transporte (frete) do equipamento até o local de instalação ou uso na Secretaria de Saúde, hospedagem de técnicos da licitante, instalação treinamento aos usuários de no mínimo 16 horas, garantia e assistência técnica por um período mínimo de 12 meses para o aparelho e transdutores, sem exibir ônus adicional além do proposto inicialmente O equipamento deverá apresentar registro na ANVISA e atender as normas NBR IEC pertinentes. Tecnicamente, caso seja necessário, as empresas licitantes *serão* convocadas a submeter seus equipamentos à avaliação prática, para que seja efetuado o aceite técnico por parte da comissão avaliadora. Tensão 127.

Jahu, 05 de janeiro de 2023

  
José Roberto Alves

Assessor

  
Ana Paula Rodrigues

Gestor - Secretária de Saúde

